

2016年4月START!

安定性試験用

中・長期検体保存サービス

このような心配はないですか？

ガイドライン変更！？
費用や時間が・・・

自社保管スペースが
もうない・・・

災害・事故のリスクが
心配だ・・・

夜間・休日に設備は
動いているかな・・・



お悩みを弊社が解決します。新サービスをご検討ください！

ここが安研の売りポイント！


- ・医薬品安定性試験に特化したモニタリングシステムの導入
※システム概要は裏面をご覧ください。
- ・CSV(GAMP, PIC/S Annex11準拠)対応, FDA21 CFR Part11対応
- ・自家発電装置・バックアップチャンバー完備
- ・お客様の試験予定に柔軟・迅速に対応可能



安研の検体保存サービス

データロスが極めて少ないため、安定した長期の検体保存が可能です！

NASTER System

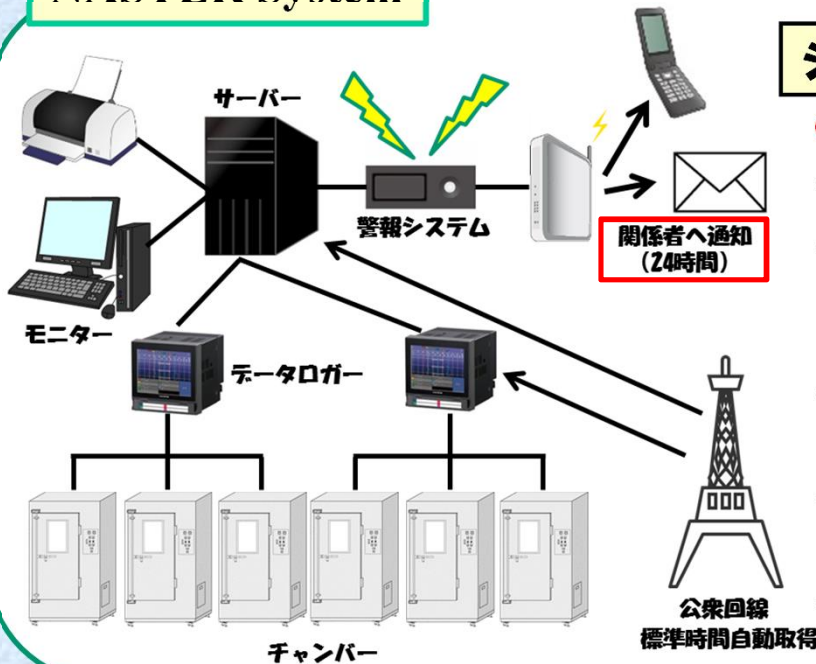

システムの特徴

CSVおよびFDA21 CFR Part11対応

- ・アクセス管理, 監査証跡機能
- ・インシデント管理
警報ランプによる通知
遠隔通報装置による電話・メール通知
- ・データロス・ゼロ化
複数の記録媒体によるデータ蓄積
- ・日本標準時間をサーバーとデータロガーで自動設定
- ・フレキシブルなデータ表示・出力

仕様紹介

- ・保管条件(長期安定性試験) $25 \pm 2^\circ\text{C} / 60 \pm 5\% \text{RH}$ (ICH Q1準拠)
(加速試験) $40 \pm 2^\circ\text{C} / 75 \pm 5\% \text{RH}$
 - ・保管区画容積※
(※) 例: 36 L (幅30 × 奥行40 × 高さ30 cm)
 - ・無停電装置(自家発電装置)完備
 - ・バックアップチャンバー完備
- ご予算に合わせてご検討いただけます。

試験開始までの流れ

ご依頼・ご相談 → お見積り → ご契約 → 試験開始

ご相談、お見積りは無料です。
設備、システムのご見学も随時受け付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください！



お問い合わせ先

富山県くすり政策課GMP適合試験検査機関

株式会社 安全性研究センター

〒930-0809 富山県富山市興人町2番62号
TEL 076-431-6810 FAX 076-431-2809
URL <http://www.anken.net/>
担当 前田 anken-maeda@cello.ocn.ne.jp
沓掛(くつかけ) kutsukake@anken.net
柳本(やなもと) yanamoto@anken.net
藤井 y-fujii@anken.net

登録番号/計量証明事業登録

- ◎登録番号 第512号(濃度に係る計量証明)
- ◎登録番号 第204号(騒音に係る計量証明)
- ◎登録番号 第振1号(振動に係る計量証明)
- 厚生労働省登録
◎水質検査機関第182号
水道GLP(水道水質検査優良試験所)
◎認定番号 JWVA-GLP120
建築物飲料水水質検査業登録
◎登録番号23水第4-07号
作業環境測定機関登録
◎登録番号第16-8号